

Simplifique Su Flujo de Trabajo

Placa de Recuento de *Bacillus cereus* (BC) Neogen® Petrifilm®


La preparación del agar MYP para *B. cereus* puede ser laboriosa y requiere manipular sustratos peligrosos que son perecederos y necesitan refrigeración. Además, la norma ISO 7932 recomienda pasos de secado para este agar antes y después de inocular la muestra, lo que añade tiempo al proceso. Con las placas Petrifilm BC, puede obtener resultados en tan solo unos sencillos pasos.



Método de Referencia del Agar Manitol, Yema de Huevo y Polimixina



Proceso en Placa Petrifilm BC

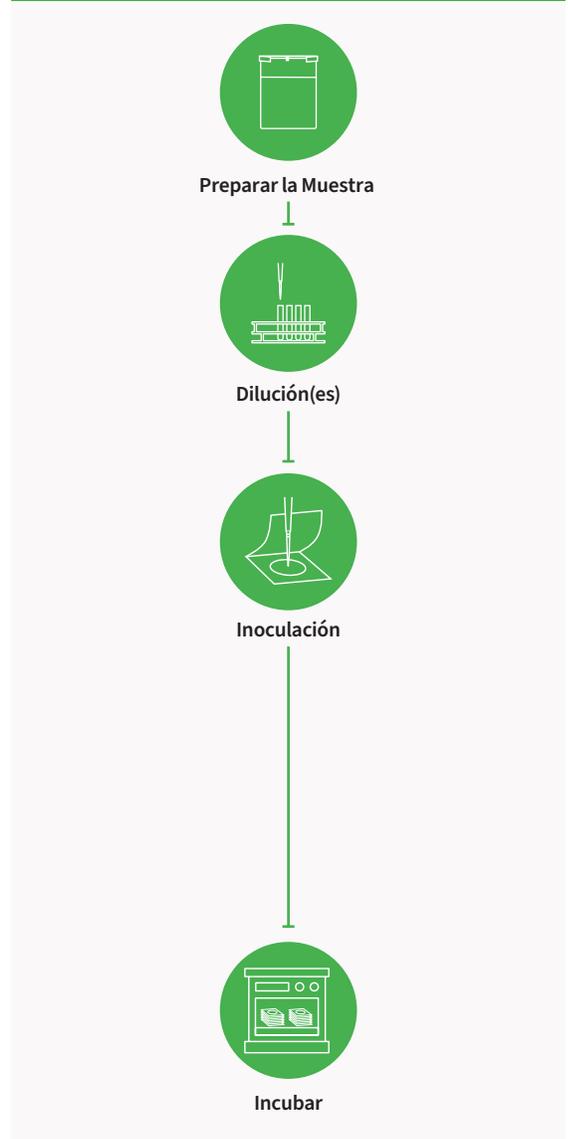

Es fácil de usar. Fácil de leer.* Fácil de interpretar.* Para solicitar una muestra o aprender más, visite info.neogen.com/Petrifilm

*En comparación con el agar del método de referencia.